

Teknik şartname**TRIZol Teknik Şartnamesi**

- Ürün 100 ml'lik orijinal ambalajında olmalıdır.
- Ürün yüksek kaliteli total RNA izolasyonu veya çeşitli biyolojik numunelerden RNA, DNA ve proteinin eşzamanlı izolasyonu için eksiksiz, kullanıma hazır bir reaktif olmalıdır.
- Ürün bir saat içinde insan, hayvan, bitki, maya veya bakteri kaynaklı hücre ve doku örneklerinden ayrı RNA, DNA ve protein fraksiyonlarını izole etmek için tasarlanmış olmalıdır.
- İzole RNA; RT-PCR, Northern Blot analizi, Dot Blot hibridizasyonu ve moleküler klonlamada kullanılabilir olmalıdır.
- İzole DNA; PCR, Restriction Enzyme digestion ve Southern Blot'ta kullanılabilir olmalıdır.
- İzole protein; Western Blot da kullanılabilir olmalıdır.
- Teklif veren firma gerektiğinde teknik destek sağlayabilmelidir.
- Teklif veren firma yetki belgesini teklife eklemelidir.
- Ürün 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

Master Mix Teknik Şartnamesi

- Ürün 5 ml'lik orijinal ambalajında olmalıdır.
- Ürün içerisinde DNA'ya bağlanabilen BRYT Green floresan boya olmalıdır.
- Ürün 2X master mix formatında olmalı ve GoTaq Hot Start Polymerase, MgCl₂, dNTPs, BRYT Green Dye ve reaksiyon için gerekli koşullarda bir reaksiyon buffer içermelidir. Aynı zamanda düşük miktarda carboxy-X-rhodamine (CXR) referans boyası içermelidir.
- Ürün ile 500 × 20µl reaksiyon ya da 1,000 × 10µl reaksiyon çalışılabilir.
- Ürün düşük kopya sayısını tanımlayabilecek kadar hassas olmalıdır.
- Her türlü real-time cihazına uygun olmalıdır.
- Ürün içeriğinde; 5 × 1ml GoTaq® qPCR Master Mix, 2X • 100µl CXR Reference Dye, 30µM • 2 × 13ml Nuclease-Free Water olmalıdır.
- Teklif veren firma gerektiğinde teknik destek sağlayabilmelidir.
- Teklif veren firma yetki belgesini teklife eklemelidir.
- Ürün 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

cDNA Synthesis Transcription Kiti Teknik Şartnamesi

- Ürün 200 rxn'luk orijinal ambalajında olmalıdır.
- Tek bir 20 µL reaksiyonda 2 µg'a kadar toplam RNA'nın tek iplikli cDNA'ya kantitatif dönüşümü için gerekli tüm bileşenleri içermelidir.
- Ürün konsantrasyonu 25X olmalıdır.
- Kit primer-probe yöntemi ile çalışmalıdır.
- Final ürün boyutu 7 kb'dan az olmalıdır
- Kit Real-Time Quantitative PCR (qPCR), Reverse Transcriptase PCR (RT-PCR) yöntemleri ile çalışabilmelidir.

- Ürün içeriği; 1 × 1mL of 10X RT Buffer; 1 × 1mL of 10X RT Random Primers; 1 × 0.2mL of 25X dNTP Mix (100mM); 1 × 0.2mL of MultiScribe Reverse Transcriptase (50U/μL) şeklinde olmalıdır
- Kitin çalışmaması durumunda firma tarafından yeni kit ücretsiz olarak temin edilebilmelidir.
- Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.
- Teklif veren firma gerektiğinde teknik destek sağlayabilmelidir.
- Teklif veren firma yetki belgesini teklife eklemelidir.
- Ürünler 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

Primer Teknik Şartnamesi

- 50 nmol Hacminde HPLC saflıkta olmalıdır.
- En geç 7 gün içinde teslim edilmelidir.
- Primerler daha önce laboratuvarımızda denenmiş ve uygunluk alınmış laboratuvarlarda sentezlenmiş olmalıdır.
- Yurtdışı menşei olmalı, uzak doğu menşei olmamalıdır.
- Primerlerin optimizasyonunda 3 gün uygulama desteği sağlanmalıdır. Primer istenilmesi durumunda çeşitli floresens boyalarla işaretlenebilmelidir.
- Çalışmayan primerler en geç 5 gün içinde yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilmelidir.
- Primerin kullanımı süresinde tüm uygulama aşamaları için ürün uzmanı tarafından destek sağlanacağı teklifle beraber taahhüt edilmelidir.
- Primerler mutlaka uygun şartlarda direkt olarak teslim edilmelidir, kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.
- Firma istenildiği takdirde yetki belgesi sunabilmelidir.

Alcian Blue 8GX Teknik Şartnamesi

- Toz formunda bulunmalıdır.
- Suda çözünürlüğü 1 mg/ml olmalıdır.
- Asidik glikozaminoglikanlarla çözünmeyen kompleksler oluşturarak glikozaminoglikanların kantitatif tayini yapmalıdır.
- Kemik ve kıkırdağın boyanmasında kullanılmalıdır.

Kondrosit Farklılaşma Kiti Teknik Şartnamesi

- Hücre kültüründe mezenkimal kök hücrelerin (MKH'ler) osteojenik farklılaşmasını sağlamalıdır.
- Kök hücre farklılaşması için kullanılmalıdır.
- 1000 mg/L Glukoz içermelidir.
- Endotosin seviyesi ≤50 EU/mL olmalıdır.
- 110 mg/L Sodyum Pyruvate içermelidir.
- Sıvı formda olmalıdır.
- HEPES içermemelidir.
- Phenol Red içermemelidir.
- Standard Serum içermelidir.
- Osteocyte/Chondrocyte Differentiation Basal Mediumu (100ml) içermelidir. Bazal medyum karanlıkta 2°C-8°C'de saklanabilir olmalıdır.
- Osteogenesis Supplement (10 ml) içermelidir. -5°C - -20°C'de karanlıkta saklanabilir olmalıdır.

25373

ANALİTİK TERAZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Cihazın Max tartım kapasitesi 220 g olmalıdır.
2. Cihazın hassasiyeti 0,0001 g olmalıdır.
3. Cihazın tekrarlanabilirliği 0,0001 g olmalıdır.
4. Cihazın doğrusalığı $\pm 0,0002$ g olmalıdır.
5. Cihazın hassasiyet kayması 10°C ile 30°C de $\pm 2/ \text{C}$ ppm olmalıdır.
6. Cihazın çalışma sıcaklığı 5°C ile 40°C arasında olmalıdır.
7. Cihazın kararlı tartıma ulaşma süresi 3 saniyeden fazla olmamalıdır.
8. Cihaz gövdesi uzun süreli ve güvenli kullanım için antimanyetik alışımdan üretilmiş olmalıdır.
9. Cihazın tartım düzeneği güvenilir, kararlı ve hızlı ölçüm amacıyla UniBloc teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.
10. Cihaz, tanecik sayım özelliği (pcs),g, mg, ct, %, gibi 17 farklı birimde tartım yapabilmelidir.
11. Opsiyonel yoğunluk kiti ile yoğunluk ölçümü yapabilmelidir.
12. Cihazın tartım kefesi çapı 90 mm'den az olmamalı ve korozyona mukavim manyetik olmayan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
13. Cihazda net toplam ve formülasyon özelliği bulunmalıdır.
14. Cihazda komparatör fonksiyonu bulunmalıdır.
15. Cihazda hırsızlığa ve yetkisiz kişilerin kullanımına karşı şifreli menü kilidi koruması olmalıdır.
16. Cihazın sağdan, soldan ve üstten olmak üzere 3 yönden açılabilir analitik cam koruma kabini olmalıdır. Camlar temizlik için kolayca sökülebilir olmalıdır.
17. Cihaz, tek bir tuşa basmak sureti ile veya sıcaklık değişimlerinde otomatik dahili kalibrasyon yapabilmelidir.
18. Cihazda, bulunduğu ortam koşullarına adapte olabilmesi için 5 kademeli dijital filtre olmalıdır.
19. Cihaz göstergesi LCD (sıvı kristal) olmalıdır.
20. Cihaz üzerinde teraziyi açma/kapama tuşu, tara alma tuşu, fonksiyonlar için ayar tuşu, yazıcı ve bilgisayar için veri alış verişi veri tuşu, ağırlık birimlerini ve hassasiyetlerini ayarlamak için bir tuş ile kalibrasyon tuşu olmalıdır.
21. Cihazda zaman ayarlı otomatik kapanma fonksiyonu olmalıdır.
22. Cihaz Opsiyonel yazıcı ile kullanıldığında her ölçüm yapıldığında sonuçları otomatik olarak yazdırabilmelidir. Ayrıca önceden ayarlı zaman aralıklarında sonuç çıktısı alınabilmelidir.
23. Cihaz üzerinde, bulunduğu yerde dengede olup olmadığını kontrol için su terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı, denge ayar ayakları olmalıdır.
24. Cihazda RS-232C ve USB portları bulunmalıdır. Cihaz hiçbir ara yazılıma gerek duymadan tartım sonuçlarını direkt olarak Windows® işletim sistemine aktarabilmelidir.
25. Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.
26. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.
27. Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip olmalıdır.
28. Cihaza teklif veren firmanın Türkiye yetkili temsilcisi olması ya da Türkiye yetkisi temsilcisinden bu Satınalma ile ilgili satış yetki belgesine sahip olmalı.

24

25373

DEPO RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Raf Sistemi Tamamıyla metal malzemeden imal edilmelidir. Raf sisteminin montajından önce kullanılacak malzemelerin tamamının tüm yüzeyleri, temizleme işlemi için fosfatlama yapıldıktan sonra en az 50 μ (mikron) kalınlığında insan sağlığına zararsız epoksi polyester esaslı elektrostatik toz boyayla kaplanıp 200°C sıcaklıkta fırınlanarak korozyona karşı mukavemeti artırılmış olacaktır.
- 2- Profil Et Kalınlığı En Az 2 mm Olmalı
- 3- Rafın (Travers) Et Kalınlığı En Az 1.5 mm Olmalı
- 4- Rafların Kalınlığı En Az 100 Kg Taşıma Kapasitesine Sahip Olmalı
- 5- Rafların Uzunluğu En Az 93 cm Olmalı
- 6- Rafların Genişliği En Az 43 cm Olmalı
- 7- Raf Sisteminin Boyu En Az 200 cm Olmalı
- 8- Kolay Kurulabilir, Kuruma Yönelik Vidaları ve Diğer Tutturucu Malzemeleri Verilmeli
- 9- 5 katlı raflardan toplam 10 adet olacaktır.
- 10- Yüklenici firma rafların tamamını kuracaktır ve devrilmeye karşı duvara sabitlenmelidir.

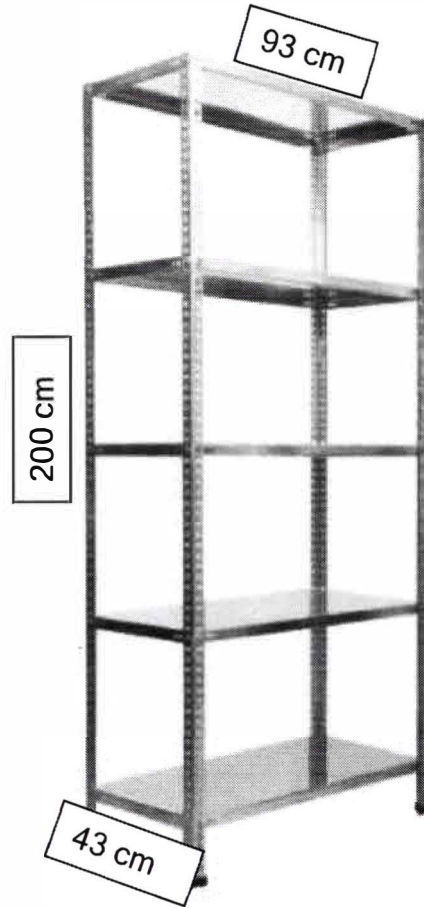

JM

25373

**FT-IR Cihazı Bakım ve
Desicant Deęiřimi Bedeli Teknik Őartname**

- 1- Cihazın optik ve mekanik testleri yapılacak.
- 2- Cihazın genel bakım ve kontrolleri yapılacak.
- 3- Cihazın desicant kitleri deęiřtirilerek optik temizlik ve purge iřlemleri yapılacak.

24

SEM Cihazı Onarımı ve Bakımı Teknik Şartname

- 1- Cihazın Optik Birimindeki mekanik ve elektronik sorun giderilecek.
- 2- Cihazın genel kontrolleri ve bakımı yapılacak.
- 3- Cihazın optik ve mekanik testleri yapılarak teslim edilecek.

25373

**UV-Vis Cihazı Motor arızası
Giderimi ve Bakımı Teknik Şartname**

- 1- Cihazın optik ve mekanik testleri yapılacak.
- 2- Optik sistemindeki mekanik ve elektronik arıza giderilecek.
- 3- Cihazın genel bakım ve kontrolleri yapılacak.



25373

**Edwards Marka Vakum
Pompaı Bakımı (GCMS için
kullanılan) Teknik Şartname**

- 1- Cihazın mekanik aksanındaki ve yüksek vakum birimlerindeki vakum iyileřtirme bakımı yapılacaktır.
- 2- Pompanın deęiřmesi gereken ömürlü o-ring, keçe, vakum yaęı, silika gibi sarfları deęiřtirilecek.
- 3- Cihazın genel bakım temizlięi yapılacak, performans iyileřtirmesi yapılacak.
- 4- Cihazın vakum sistemindeki sorunları giderilecek.

24

25373

YAPRAK BUZ MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Üretim Kapasitesi, Kapasite verileri 21°C oda sıcaklığında ve 15°C su sıcaklığında min 80 kg/gün olmalı
- 2- Soğutma Tipi: Hava Soğutmalı olmalı
- 3- Güç değeri 700 W olmalı
- 4- Gaz Tipi R 452A olmalı
- 5- Saklama Kapasitesi: 15 kg olmalı
- 6- Suyu emen sistem özelliği olmalı ve nemsiz buz üretebilmeli
- 7- Voltaj: 230V / 50 Hz değerinde çalışmalı.
- 8- Fan sistemi önden olmalı ve dar alanda ısı problemi olmadan çalışabilmeli.
- 9- Paslanmaz çelik den imal edilmiş olmalı.
- 10- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

24

25373

**Azot Protein Cihazı Motor
Arızası ve Destilasyon Ünitesi
Onarımı ve Bakımı Teknik Şartname**

- 1- Cihazın mekanik aksanındaki ve tahliye sistemindeki motor arızası giderilecek.
- 2- Cihazın genel bakım ve kontrolleri yapılacak.
- 3- Tahliye ve sıvı sevk sistemindeki sorunları giderilecektir.
- 4- Cihazın destilasyon birimindeki sorun giderilerek gerekli temizlik ve bakımı yapılacak.


21

25376

Saksı ve torf için teknik şartname

Saksılar 6 lt hacminde. 25-26 cm yükseklikte ve saksı ağız kare şeklinde 16x16 cm ebatlarında olacak.

Torf, saksıda bitki yetiřtirmeye uygun, mineral maddelerce zengin ve toplam 600 kg olacak:


Prof. Dr. Faruk Toklu

08.09.2023

25377

GENEL TEKNİK ŞARTNAME

- Teklif edilen ürünler aşağıdaki belirtilen özellikleri birebir karşılamalıdır.
(ürün teslimatı sırasında şartname maddeleri tek tek kontrol edilecektir.)
- Muadil ürün kabul edilmeyecektir.
- Teslim süresi siparişten sonra en fazla 5 iş günüdür (Aksi Belirtilmedikçe).
- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Teslimat Firma yetkililerince yapılmalıdır

SABOURAUD 4% dextroseagar 500 gr teknik şartnamesi

- 1-Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- 2-Ürün analiz sertifikası ve Türkçe MSDS ürün ile birlikte teslim edilmelidir.
- 3-Ürün S.K tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- 4-Siparişten 5 gün sonra teslimat yapılmalıdır. kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
- 5-Laboratuvardan uygunluk alınmadan teslimat kabul edilmeyecektir

Plastik petri kutusu (90mm) TEKNİK ŞARTNAME

1. Ürün ithal PS.den üretilmiş 90x17 mm ebatlarında, 10 adetli k paketlerde ve 500 adetlik kolilerde, Gamma steril özelliklerde teslim edilmelidir.
- 2-Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl sonra olmalıdır.
- 3-Siparişten 5 gün sonra teslimat yapılmalıdır. kargo ile teslimat kabul edilmeyecekti
- 4-Laboratuvardan uygunluk alınmadan teslimat kabul edilmeyecektir

Plastik petri kutusu (60mm) TEKNİK ŞARTNAME

1. Ürün ithal PS.den üretilmiş 10 adetli k paketlerde ve 980 adetlik kolilerde, Gamma steril özelliklerde teslim edilmelidir.
- 2-Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl sonra olmalıdır.
- 3-Siparişten 5 gün sonra teslimat yapılmalıdır. kargo ile teslimat kabul edilmeyecekti
- 4-Laboratuvardan uygunluk alınmadan teslimat kabul edilmeyecektir

[Handwritten signature]

25381

Yurt Dışı Satış

Yok

Stok Kodu

HBCV000007R13P

Diğer

KRONOMETRE

On anı

1/100 saniye hassasiyet

Sürekli takvim

Geri sayım, büyük sayı ekranı

Metronom

Yüksek kaliteli ABS'den üretilmiştir

CR2032 x 1 adet düğme pil ile çalışır

Alarm

Var

Kalori Hesaplama

Var

LED

Var

Saat ve Tarih Gösterimi

Var

Su Geçirmezlik

Var

1 Kut. (6 adet 42 cm çaplı çember
6 adet 48 cm çaplı çember) 12'li taşınabilir kartlı set

Hentbol Topu

- Topun boyutu: 2 No (13 yaş üzeri kızlara ve 11-13 yaş erkeklere uygun)
- Yüzeyi: Mikro deri
- Ağırlığı:339 gr
- Kullanım alanları: Indoor-Outdoor (iç-dış saha) kullanımına uygun
- Federasyon onayı: Var (IHF A)
- Diğer özellikleri: El dikişli, üzerindeki yumuşak derisi ve gözenekleri sayesinde ekstra tutma özelliği sağlayan, dayanıklı hentbol topu
- Satın alacağınız topların sibobunu vazelin ile kayganlaştırarak ve mutlaka top iğnesi kullanarak şişiriniz.
- Topu kullanmadan şişik vaziyette 24 saat bekletiniz.
- Sibobundan iğne girmeyen veya 24 saat içinde inen topları iade edebilirsiniz.
- Sibobun iğne kullanılmadan zorlanma sonucu kayması, topun içine düşmesi gibi durumlarda topun değişimi veya iadesi mümkün değildir.
- Patlayan toplarınızı Uzayspor Top Gun ile kolayca tamir edebilirsiniz.
- Topların sporcuların-öğrencilerin elinden kaymaması için vaks kullanabilirsiniz.
- Sakatlanma sırasında gerekli olabilecek anında soğuk uygulaması ihtiyacınızı da cold pack ile karşılayabilirsiniz.

HUNİ

17 cm antrenman hunisi

ANTRENMAN ÇANAK

Return 12 Li Antrenman Çanağı Set
3 ADET KIRMIZI

3 ADET SARI

3 ADET MAVİ

3 ADET BEYAZ ANTRENMAN ÇANAĞI

HARDDİSK**1TB 520MB/S Taşınabilir SSD Disk SDSSDE30-1T00-G25
Özellikleri**

USB Bağlantısı	USB 3.1
Ağırlık (gr)	100 gr
Şifre Koruma	Yok
Okuma Hızı	520 MB/s
Kapasite	<u>1 TB</u>
Yazma Hızı	520 MB/s
Garanti Süresi (Ay)	24

25386

TEKNİK ŞARTNAME

Acetic Acid-2,5 lt	<p>Ürün (adları) IMPROVED HPLC IMPROVED ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, E 260 formda olmalı. 2,5 lt.lik amber cam şişede teslim edilmelidir. İthal ve Avrupa menşeli olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl sonra olmalıdır.</p> <p>Ürün; analiz sertifikası ve MSDS formu ile birlikte teslim edilmelidir.</p> <p>Laboratuvarınızda daha önceden kullanılmış ve denenmiş olmalıdır. 5 iş günü içerisinde teslim edilmelidir. Belirtilen özelliklerin belgelenmesi gerekmektedir, belgelenemeyen ve bu özellikleri taşımayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.</p>
Ethanol-2,5 lt	<p>Ürün minimum %99 saflıkta gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv formda olmalı, 2,5 lt.lik amber cam şişede teslim edilmelidir. İthal ve Avrupa menşeli olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl sonra olmalıdır.</p> <p>Ürün; analiz sertifikası ve MSDS formu ile birlikte teslim edilmelidir.</p> <p>Laboratuvarınızda daha önceden kullanılmış ve denenmiş olmalıdır. 5 iş günü içerisinde teslim edilmelidir. Belirtilen özelliklerin belgelenmesi gerekmektedir, belgelenemeyen ve bu özellikleri taşımayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.</p>
n-Heptane-2,5 lt	<p>Ürün %99,3 saflıkta for liquid chromatography LiChrosolv® formda olmalı, 2,5 lt.lik amber cam şişede teslim edilmelidir. İthal ve Avrupa menşeli olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl sonra olmalıdır.</p> <p>Ürün; analiz sertifikası ve MSDS formu ile birlikte teslim edilmelidir.</p> <p>Laboratuvarınızda daha önceden kullanılmış ve denenmiş olmalıdır. 5 iş günü içerisinde teslim edilmelidir. Belirtilen özelliklerin belgelenmesi gerekmektedir, belgelenemeyen ve bu özellikleri taşımayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.</p>
Metanol	<p>Ürün minimum %99 saflıkta gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv formda olmalı, 2,5 lt.lik amber cam şişede teslim edilmelidir. İthal ve Avrupa menşeli olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl sonra olmalıdır.</p> <p>Ürün; analiz sertifikası ve MSDS formu ile birlikte teslim edilmelidir.</p> <p>Laboratuvarınızda daha önceden kullanılmış ve denenmiş olmalıdır. 5 iş günü içerisinde teslim edilmelidir. Belirtilen özelliklerin belgelenmesi gerekmektedir, belgelenemeyen ve bu özellikleri taşımayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.</p>

Prof. Dr. Jesim Özgül



Teknik Şartname (FDK-2023-15331)

Sera Plastiği: 36 Aylık NOR UV+Clear IR+EVA+AF

Kalınlık 180 mikron, Ortalama Kalınlık Dağılımı Toleransı ± 5 , Herhangi bir noktada Kalınlık Dağılımı Toleransı ± 15

Mekanik Özellikler Kopmada Çekme Dayanımı MD 23 Mpa

Kopmada Uzama MD 600 % EN ISO 527-3 TD 750 %

Akmada Çekme Dayanımı MD 11 Mpa

Darbe Düşürme Testi Gövde 1250 g

Optik Özellikler Toplam Görünür Işık Geçirgenliği 87-89 %

Pusluluk 45 %

Termal Etki > 82

Diğer Özellikler Anti-Fog (Anti-Drip) Özelliği (*) Var

Buffer solution pH 7.00 di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), 1 litre, traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (20°C) Certipur: yoğunluğu 1.01 g/cm³ (20 °C) o

Askorbik Asit: %99,5 saflıkta, 2.4-2.8 ph aralığında 1 kg ağırlığında

Hidrojen peroksit: % 98 saflıkta ve 2,5 litre ağırlıkta

Data logger: veri alma aralığı : -40°C +85°C, su geçirmez, Doğruluk : $\pm 1^\circ$ kapasite 8000 veri kaydetme, batarya ömrü: ± 1 year

Basınçlı mekanik sırt tipi ilaçlama pompası: hava Bölme Kapasitesi : 0.9 lt Tank Kapasitesi : 16 lt Dayanma Basıncı : 1 mpa Hortum Uzunluğu : 120 cm Püskürtme Çubuğu Uzunluğu : 60 cm

Glisin betain: 25 kg ağırlıkta, 99.7 % saflık, pH: 5.9 - 6.4 aralığı

Kaba filtre (Kurutma) Kağıdı (250 Adet): 60 gr/m² ağırlık, 0.130 mm kalınlık, 0.280/0.230 kN/M nem direnci

Kese kağıdı: her bir paket 100 adet olmak üzere 2 paket 12*20 boyutlarında, Her birinde 500 adet olmak üzere 2 paket 33*15,5*8 boyutlarında

Kilitli naylon poşet: 1000 adet 16*20 boyutlarda

o-Dianisidine: 5 gr ağırlıkta sigma marka

Petri kabı: 90*17 cm büyüklükte 500 adet

Zeytin fidanı: 200 adet 2 yaşlı homojen Halhalı zeytin fidanı

25390

Prof. Dr. Sergi Paydas Karpı
Proje Yürütücüsü

25391

Teknik Şartname (FDK-2023-15331)

Sera Plastiği: 36 Aylık NOR UV+Clear IR+EVA+AF

Kalınlık 180 mikron, Ortalama Kalınlık Dağılımı Toleransı ± 5 , Herhangi bir noktada Kalınlık Dağılımı Toleransı ± 15

Mekanik Özellikler Kopmada Çekme Dayanımı MD 23 Mpa

Kopmada Uzama MD 600 % EN ISO 527-3 TD 750 %

Akmada Çekme Dayanımı MD 11 Mpa

Darbe Düşürme Testi Gövde 1250 g

Optik Özellikler Toplam Görünür Işık Geçirgenliği 87-89 %

Pusluluk 45 %

Termal Etki > 82

Diğer Özellikler Anti-Fog (Anti-Drip) Özelliği (*) Var

Buffer solution pH 7.00 di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), 1 litre, traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (20°C) Certipur: yoğunluğu 1.01 g/cm³ (20 °C) o

Askorbik Asit: %99,5 saflıkta, 2.4-2.8 ph aralığında 1 kg ağırlığında

Hidrojen peroksit: % 98 saflıkta ve 2,5 litre ağırlıkta

Data logger: veri alma aralığı : -40°C +85°C, su geçirmez, Doğruluk : $\pm 1^\circ$ kapasite 8000 veri kaydetme, batarya ömrü: ± 1 year

Basınçlı mekanik sırt tipi ilaçlama pompası: hava Bölme Kapasitesi : 0.9 lt Tank Kapasitesi : 16 lt Dayanma Basıncı : 1 mpa Hortum Uzunluğu : 120 cm Püskürtme Çubuğu Uzunluğu : 60 cm

Glisin betain: 25 kg ağırlıkta, 99.7 % saflık, pH: 5.9 - 6.4 aralığı

Kaba filtre (Kurutma) Kağıdı (250 Adet): 60 gr/m² ağırlık, 0.130 mm kalınlık, 0.280/0.230 kN/M nem direnci

Kese kağıdı: her bir paket 100 adet olmak üzere 2 paket 12*20 boyutlarında,

Her birinde 500 adet olmak üzere 2 paket 33*15,5*8 boyutlarında

Kilitli naylon poşet: 1000 adet 16*20 boyutlarda

o-Dianisidine: 5 gr ağırlıkta sigma marka

Petri kabı: 90*17 cm büyüklükte 500 adet

Zeytin fidanı: 200 adet 2 yaşlı homojen Halhalı zeytin fidanı

Prof. Dr. Sergi Paydas Kargı
Proje Yürütücüsü

25392

Proforma

Vakum Sızdırmazlık Bandı (15 m)

P

Temsili fiyat için internet adresi:

<https://www.kompozitpazari.com/urun/vakum-sizdirmezlik-macunu>



Vakum Sızdırmazlık Macunu 170 °C

293,68 TL

Ürün Adı: Vakum Sızdırmazlık Macunu
Dış Kodu: 3050044239970119910201
Marka: Sander
Net Ağırlık (kg): 15
Kategori: Makine
Miktar: 190,74 TL (10,150 adet) (KDV Dahil)
2019 TL Kurum Kayıt No: 3050044239970119910201

293,68 TL (KDV Dahil) (10,150 adet) (KDV Dahil)

293,68 TL (KDV Dahil) (10,150 adet) (KDV Dahil)

293,68 TL (KDV Dahil) (10,150 adet) (KDV Dahil)

(Handwritten signature)

25394

Teknik Şartname

- 1- Genotiplendirme kiti ile 25 örnekte ST131 klonu, CTX-M-1 ve CTX-M-15 genlerinin tespiti yapılabilir.
- 2- Önerilen kitler Roche Light Cycler 96 cihazına uygun olmalı; Tedarikçi firma cihaz kullanımı ve uygulamalar için gerektiğinde aplikasyon desteği sağlamalıdır.
- 3- Kitle beraber kullanılacak real time pcr cihazına uygun olarak plastik sarf malzemeler ücretsiz olarak yeterli miktarda temin edilmelidir.
- 4- Yüklenici firma Yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır. Kitte yaşanan sorunlar karşısında firma tarafından yenisi ile bedelsiz değişimi yapılmalıdır.
- 5- Önerilen tüm sarf malzemeler uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir. Tüm ürünler orijinal ambalajında olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ETİZ



25398

BDNF Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody

- Teklif edilen antikor WB, IHC (P), ICC/IF teknikleri için kullanıma uygun olmalıdır.
- Ürün 100 µL ambalajında olmalıdır.
- Teklif edilen antikor Rabbit / IgG olmalıdır.
- Teklif edilen antikor Human, Mouse, Rat türlerinde reaktivite göstermelidir.
- Teklif edilen antikor performance grade olmalıdır. Antikor çalışmadığı takdirde 15 gün içerisinde ücretsiz değişimi yapılmalıdır.
- Teklif edilen antikor; WB 1:1,000-1:2,000; IHC (P) 1:50-1:200 ve ICC/IF 1:50-1:200 uygulamalarında belirtilen oranlarda seyreltilerek kullanılabilir.
- Ürün konsantrasyonu 1 mg/ml olmalıdır.
- Teklif edilen antikorun saklama buffer'ı TBS, pH 7.4, with 40% glycerol, 0.05% BSA (0.05% sodium azide içeren) olmalıdır.
- Teklif edilen antikor için numune denemesi yapılmış olmalıdır ve uygunluk yazısı alınmış olmalıdır. Uygunluk yazıları ilk defa kullanılacak ürünler için teklif ile beraber sunulmalıdır. Uygunluk yazısı verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Yüklenici firma gerektiğinde, çalışmayan antikor için teknik destek sağlayıp çalışmayı yapabilmelidir.
- Yüklenici firma ihalede yetki belgesini sunmalıdır. Yüklenici firmalar elden teslim etmelidir.

TNF alpha Polyclonal Antibody

- Teklif edilen antikor WB, IHC (P), ICC/IF, Flow, ELISA teknikleri için kullanıma uygun olmalıdır.
- Ürün 100 µL ambalajında olmalıdır.
- Teklif edilen antikor Rabbit / IgG olmalıdır.
- Teklif edilen antikor Human, Mouse, Rat türlerinde reaktivite göstermelidir.
- Teklif edilen antikor performance grade olmalıdır. Antikor çalışmadığı takdirde 15 gün içerisinde ücretsiz değişimi yapılmalıdır.
- Teklif edilen antikor; WB 1:1,000; IHC (P) 1:50; ICC/IF 1:100; Flow 1:50 ve ELISA 1:50 uygulamalarında belirtilen oranlarda seyreltilerek kullanılabilir.
- Ürün konsantrasyonu 0.1 mg/mL olmalıdır.
- Teklif edilen antikorun saklama buffer'ı PBS with 0.1% BSA olmalıdır.
- Teklif edilen antikor için numune denemesi yapılmış olmalıdır ve uygunluk yazısı alınmış olmalıdır. Uygunluk yazıları ilk defa kullanılacak ürünler için teklif ile beraber sunulmalıdır. Uygunluk yazısı verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Yüklenici firma gerektiğinde, çalışmayan antikor için teknik destek sağlayıp çalışmayı yapabilmelidir.
- Yüklenici firma ihalede yetki belgesini sunmalıdır. Yüklenici firmalar elden teslim etmelidir.

IL-6 Monoclonal Antibody

- Teklif edilen antikor WB, IHC (P), ICC/IF, Flow, ELISA teknikleri için kullanıma uygun olmalıdır.
- Ürün 100 µL ambalajında olmalıdır.
- Teklif edilen antikor Mouse / IgG2b olmalıdır.

- Teklif edilen antikor Human, Mouse, Rat türlerinde reaktivite göstermelidir.
- Teklif edilen antikor performance grade olmalıdır. Antikor çalışmadığı takdirde 15 gün içerisinde ücretsiz değişimi yapılmalıdır.
- Teklif edilen antikor; WB 1:500-1:2,000; IHC (P) 1:50-1:200; ICC/IF 1:50-1:200; uygulamalarında belirtilen oranlarda seyreltilerek kullanılabilir.
- Ürün konsantrasyonu 2 mg/ml olmalıdır.
- Teklif edilen antikorun saklama buffer'ı PBS, pH 7.4, with 50% glycerol, 0.2% BSA (0.05% sodium azide içeren) olmalıdır.
- Teklif edilen antikor için numune denemesi yapılmış olmalıdır ve uygunluk yazısı alınmış olmalıdır. Uygunluk yazıları ilk defa kullanılacak ürünler için teklif ile beraber sunulmalıdır. Uygunluk yazısı verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Yüklenici firma gerektiğinde, çalışmayan antikor için teknik destek sağlayıp çalışmayı yapabilmelidir.
- Yüklenici firma ihalede yetki belgesini sunmalıdır. Yüklenici firmalar elden teslim etmelidir.

Bax Monoclonal Antibody

- Teklif edilen antikor WB, IHC (P), ICC/IF, Flow, teknikleri için kullanıma uygun olmalıdır.
- Ürün 100 µL ambalajında olmalıdır.
- Teklif edilen antikor Mouse / IgG1 olmalıdır.
- Teklif edilen antikor Human, Mouse, Rat türlerinde reaktivite göstermelidir.
- Teklif edilen antikor performance grade olmalıdır. Antikor çalışmadığı takdirde 15 gün içerisinde ücretsiz değişimi yapılmalıdır.
- Teklif edilen antikor; WB 1:10-1:100; IHC (P) 1:50-1:200; ICC/IF 1:10-1:100; Flow 0.5 µg/test uygulamalarında belirtilen oranlarda seyreltilerek kullanılabilir.
- Ürün konsantrasyonu 0,2 mg/ml olmalıdır.
- Teklif edilen antikorun saklama buffer'ı PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA (0.09% sodium azide içeren) olmalıdır.
- Teklif edilen antikor için numune denemesi yapılmış olmalıdır ve uygunluk yazısı alınmış olmalıdır. Uygunluk yazıları ilk defa kullanılacak ürünler için teklif ile beraber sunulmalıdır. Uygunluk yazısı verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Yüklenici firma gerektiğinde, çalışmayan antikor için teknik destek sağlayıp çalışmayı yapabilmelidir.
- Yüklenici firma ihalede yetki belgesini sunmalıdır. Yüklenici firmalar elden teslim etmelidir.

Bcl-2 Polyclonal Antibody

- Teklif edilen antikor WB, IHC (P), ICC/IF, Flow, teknikleri için kullanıma uygun olmalıdır.
- Ürün 100 µL ambalajında olmalıdır.
- Teklif edilen antikor Rabbit / IgG olmalıdır.
- Teklif edilen antikor Human, Mouse, Rat türlerinde reaktivite göstermelidir.
- Teklif edilen antikor performance grade olmalıdır. Antikor çalışmadığı takdirde 15 gün içerisinde ücretsiz değişimi yapılmalıdır.

- Teklif edilen antikor; WB 1:500-1:3,000; IHC (P) 1:100-1:1,000; ICC/IF 1:100-1:1,000 uygulamalarında belirtilen oranlarda seyreltilerek kullanılabilir.
- Ürün konsantrasyonu 0,2 mg/ml olmalıdır.
- Teklif edilen antikorun saklama buffer'ı PBS, pH 7, with 1% BSA, 20% glycerol (0.025% ProClin 300 içeren) olmalıdır.
- Teklif edilen antikor için numune denemesi yapılmış olmalıdır ve uygunluk yazısı alınmış olmalıdır. Uygunluk yazıları ilk defa kullanılacak ürünler için teklif ile beraber sunulmalıdır. Uygunluk yazısı verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Yüklenici firma gerektiğinde, çalışmayan antikor için teknik destek sağlayıp çalışmayı yapabilmelidir.
- Yüklenici firma ihalede yetki belgesini sunmalıdır. Yüklenici firmalar elden teslim etmelidir.

PLP1 Monoclonal Antibody

- Teklif edilen antikor WB, IHC (P), ICC/IF, Flow, teknikleri için kullanıma uygun olmalıdır.
- Ürün 100 µL ambalajında olmalıdır.
- Teklif edilen antikor Mouse / IgG2a olmalıdır.
- Teklif edilen antikor Human, Mouse, Rat türlerinde reaktivite göstermelidir.
- Teklif edilen antikor performance grade olmalıdır. Antikor çalışmadığı takdirde 15 gün içerisinde ücretsiz değişimi yapılmalıdır.
- Teklif edilen antikor; ICC/IF 1:100 uygulamalarında belirtilen oranlarda seyreltilerek kullanılabilir.
- Ürün konsantrasyonu 1 mg/ml olmalıdır.
- Teklif edilen antikorun saklama buffer'ı PBS, pH 7, with 1% BSA, 20% glycerol olmalıdır.
- Teklif edilen antikor için numune denemesi yapılmış olmalıdır ve uygunluk yazısı alınmış olmalıdır. Uygunluk yazıları ilk defa kullanılacak ürünler için teklif ile beraber sunulmalıdır. Uygunluk yazısı verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Yüklenici firma gerektiğinde, çalışmayan antikor için teknik destek sağlayıp çalışmayı yapabilmelidir.
- Yüklenici firma ihalede yetki belgesini sunmalıdır. Yüklenici firmalar elden teslim etmelidir.

Mouse and Rabbit Specific HRP/AEC (ABC) Detection IHC Kit

- Kit IHC-P' de kullanıma uygun olmalıdır.
- Ürün 15 ml orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- Kit içeriği; AEC Single Solution, Biotinylated Goat Anti-Polyvalent, Protein block ve Streptavidin Peroxidase olmalıdır.
- Ürün +4°C'de saklanabilmelidir.
- Teklif edilen ürün için numune denemesi yapılmış olmalıdır ve uygunluk yazısı alınmış olmalıdır. Uygunluk yazıları ilk defa kullanılacak ürünler için teklif ile beraber sunulmalıdır. Uygunluk yazısı verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Yüklenici firma gerektiğinde, çalışmayan kit için teknik destek sağlayıp çalışmayı yapabilmelidir.
- Yüklenici firma ihalede yetki belgesini sunmalıdır.

- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir. Elden teslim edilmelidir.

Aqueous Mount

- Teklif edilen ürün ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P yöntemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- Fast-Red veya AEC gibi alkolde çözünen kromojenler ile boyanmış bölümleri doldurmak için formüle edilmiş olmalıdır.
- Ürün low-viscosity olmalıdır.
- Uygun damlalıklı şişelerde olmalıdır.
- Lameller suya batırılarak çıkarılabilir olmalıdır.
- Kullanmadan önce ısıtma gerektirmemelidir.
- AMT'den daha serbest akmalıdır.
- Ürün 30 ml'lik orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
- Ready-to-use olmalıdır.
- Ürünün saklama tamponunda koruyucu olarak 0.1% Sodium azide olmalıdır.
- Teklif edilen ürün için numune denemesi yapılmış olmalıdır ve uygunluk yazısı alınmış olmalıdır. Uygunluk yazıları ilk defa kullanılacak ürünler için teklif ile beraber sunulmalıdır. Uygunluk yazısı verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Yüklenici firma gerektiğinde, çalışmayan kit için teknik destek sağlayıp çalışmayı yapabilmelidir.
- Yüklenici firma ihalede yetki belgesini sunmalıdır.
- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir. Elden teslim edilmelidir.

PHOSPHATE BUFFERED SALINE TABLET

- PBS, immünoanalizler için, numune seyreltme için, protein saflaştırması için ve hücre kültürlerinde yıkama tamponu olarak kullanıma uygun olmalıdır.
- Ürün 10X. pH 7.4, 4L olmalıdır.
- Tablet ağırlığı 1g +/- 2% olmalıdır.
- Osmolaritesi ve iyon konsantrasyonu izotonik özellikte olmalıdır.
- Hücre kültürü için toksik özellikte olmamalıdır.
- Orjinal ambalajında 100 adet tablet bulunmalıdır.
- Teklif edilen ürün için numune denemesi yapılmış olmalıdır ve uygunluk yazısı alınmış olmalıdır. Uygunluk yazıları ilk defa kullanılacak ürünler için teklif ile beraber sunulmalıdır. Uygunluk yazısı verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Yüklenici firma gerektiğinde, çalışmayan kit için teknik destek sağlayıp çalışmayı yapabilmelidir.
- Yüklenici firma ihalede yetki belgesini sunmalıdır.
- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir. Elden teslim edilmelidir.

Citrate Buffer

- Teklif edilen ürün IHC-P çalışmasında kullanıma uygun olmalıdır.
- Ürün 10x ve pH 6.0 olmalıdır.
- Ürün 125 ml'lik orijinal ambalajında elden teslim edilmelidir.
- Deiyonize veya distile su ile 1:10 oranında seyreltilmiş olmalıdır.

25398

- Teklif edilen ürün için numune denemesi yapılmış olmalıdır ve uygunluk yazısı alınmış olmalıdır. Uygunluk yazıları ilk defa kullanılacak ürünler için teklif ile beraber sunulmalıdır. Uygunluk yazısı verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Yüklenici firma gerektiğinde, çalışmayan kit için teknik destek sağlayıp çalışmayı yapabilmelidir.
- Yüklenici firma ihalede yetki belgesini sunmalıdır.
- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir. Elden teslim edilmelidir.

Lam Polysinli Teknik Şartnamesi

- Pozitif elektrikle yüklü olmalıdır.
- Formalinle fikse doku kesitleriyle cam kısım arasında kovalent bağlar oluşturacak ve doku kaybını engelleyecek nitelikte olmalıdır.
- İn situ hibridizasyon çalışmalarında da kullanılabilir.
- Teslim sırasında 72 adet lam içeren kutularda orjinal ambalajında açılmamış olmalıdır.
- Teklif edilen ürün laboratuvarımızdaki lam boyama ve lam kapama cihazları ile sorunsuz çalışmalıdır. Uyumluluğu test edilip onay verilecektir.
- Ebatları 26x76 mm ve kalınlığı 1 - 1,03 mm olmalıdır.
- Teklif edilen ürün için numune denemesi yapılmış olmalıdır ve uygunluk yazısı alınmış olmalıdır. Uygunluk yazıları ilk defa kullanılacak ürünler için teklif ile beraber sunulmalıdır. Uygunluk yazısı verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir. Elden teslim edilmelidir.

OSMIUM TETROXİDE

- 1-Teklif edilen Osmiyum tetraoksit'in CAS numarası 20816-12-0 olmalıdır.
- 2-Her kutu 10 adet kolay kırılabilen 0.2gr'lık cam tüpler içermelidir.
- 3-Osmiyum tetraoksit elektron mikroskopisinde numune sabitlemek için kullanılmalıdır.
- 4-Yoğunluğu 20 °C'd, 4.906/22 °C g/cm³ olmalıdır.
- 5-Kaynama sıcaklığı, 130 °C olmalıdır.
- 6-Osmiyum tetraoksittoksik madde olup , göz ile temasından kaçınılmalıdır.
- 7-ELEKTRON MİKROSKOBUNDA ÇALIŞMAYA UYGUN OLMALIDIR.
- 8-Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.
- 9-Laboratuara örnek getirip uygunluk alınmalıdır.uygunluk alınmadan atılan fiyatlar geçersiz sayılacaktır
- 10-Firma tarafından çalışma süresince aplikasyoncu desteği verilmelidir.
- 11-Ürün 5 gün içerisinde teslim edilmelidir.

ARALDİTE CY212

- 1-ELEKTRON MİKROSKOBUNDA ÇALIŞMAYA UYGUN OLMALIDIR.
- 2-Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.
- 3-Laboratuara örnek getirip uygunluk alınmalıdır.uygunluk alınmadan atılan fiyatlar geçersiz sayılacaktır
- 4-Firma tarafından çalışma süresince aplikasyoncu desteği verilmelidir.
- 5- Ürün 5 gün içerisinde teslim edilmelidir.
- 6-1000 ML amlajda teslim edilmelidir.

DDS AGAR

- 1-ELEKTRON MİKROSKOBUNDA ÇALIŞMAYA UYGUN OLMALIDIR.
- 2-Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.
- 3-Laboratuara örnek getirip uygunluk alınmalıdır. uygunluk alınmadan atılan fiyatlar geçersiz sayılacaktır
- 4-Firma tarafından çalışma süresince aplikasyoncu desteği verilmelidir.
- 5- Ürün 5 gün içerisinde teslim edilmelidir.
- 6- 1000 ML ambalajda teslim edilmelidir.

BAKIR GRID

- 1-ELEKTRON MİKROSKOBUNDA ÇALIŞMAYA UYGUN OLMALIDIR.
- 2-Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.
- 3-Laboratuara örnek getirip uygunluk alınmalıdır.uygunluk alınmadan atılan fiyatlar geçersiz sayılacaktır
- 4-Firma tarafından çalışma süresince aplikasyoncu desteği verilmelidir.
- 5- Ürün 5 gün içerisinde teslim edilmelidir.

BDNF Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody

- Teklif edilen antikor WB, IHC (P), ICC/IF teknikleri için kullanıma uygun olmalıdır.
- Ürün 100 µL ambalajında olmalıdır.
- Teklif edilen antikor Rabbit / IgG olmalıdır.
- Teklif edilen antikor Human, Mouse, Rat türlerinde reaktivite göstermelidir.
- Teklif edilen antikor performance grade olmalıdır. Antikor çalışmadığı takdirde 15 gün içerisinde ücretsiz değişimi yapılmalıdır.
- Teklif edilen antikor; WB 1:1,000-1:2,000; IHC (P) 1:50-1:200 ve ICC/IF 1:50-1:200 uygulamalarında belirtilen oranlarda seyreltilerek kullanılabilir.
- Ürün konsantrasyonu 1 mg/ml olmalıdır.
- Teklif edilen antikorun saklama buffer'ı TBS, pH 7.4, with 40% glycerol, 0.05% BSA (0.05% sodium azide içeren) olmalıdır.
- Teklif edilen antikor için numune denemesi yapılmış olmalıdır ve uygunluk yazısı alınmış olmalıdır. Uygunluk yazıları ilk defa kullanılacak ürünler için teklif ile beraber sunulmalıdır. Uygunluk yazısı verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Yüklenici firma gerektiğinde, çalışmayan antikor için teknik destek sağlayıp çalışmayı yapabilmelidir.
- Yüklenici firma ihalede yetki belgesini sunmalıdır. Yüklenici firmalar elden teslim etmelidir.

TNF alpha Polyclonal Antibody

- Teklif edilen antikor WB, IHC (P), ICC/IF, Flow, ELISA teknikleri için kullanıma uygun olmalıdır.
- Ürün 100 µL ambalajında olmalıdır.
- Teklif edilen antikor Rabbit / IgG olmalıdır.
- Teklif edilen antikor Human, Mouse, Rat türlerinde reaktivite göstermelidir.
- Teklif edilen antikor performance grade olmalıdır. Antikor çalışmadığı takdirde 15 gün içerisinde ücretsiz değişimi yapılmalıdır.
- Teklif edilen antikor; WB 1:1,000; IHC (P) 1:50; ICC/IF 1:100; Flow 1:50 ve ELISA 1:50 uygulamalarında belirtilen oranlarda seyreltilerek kullanılabilir.
- Ürün konsantrasyonu 0.1 mg/mL olmalıdır.
- Teklif edilen antikorun saklama buffer'ı PBS with 0.1% BSA olmalıdır.
- Teklif edilen antikor için numune denemesi yapılmış olmalıdır ve uygunluk yazısı alınmış olmalıdır. Uygunluk yazıları ilk defa kullanılacak ürünler için teklif ile beraber sunulmalıdır. Uygunluk yazısı verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Yüklenici firma gerektiğinde, çalışmayan antikor için teknik destek sağlayıp çalışmayı yapabilmelidir.
- Yüklenici firma ihalede yetki belgesini sunmalıdır. Yüklenici firmalar elden teslim etmelidir.

IL-6 Monoclonal Antibody

- Teklif edilen antikor WB, IHC (P), ICC/IF, Flow, ELISA teknikleri için kullanıma uygun olmalıdır.
- Ürün 100 µL ambalajında olmalıdır.
- Teklif edilen antikor Mouse / IgG2b olmalıdır.

- Teklif edilen antikor Human, Mouse, Rat türlerinde reaktivite göstermelidir.
- Teklif edilen antikor performance grade olmalıdır. Antikor çalışmadığı takdirde 15 gün içerisinde ücretsiz değişimi yapılmalıdır.
- Teklif edilen antikor; WB 1:500-1:2,000; IHC (P) 1:50-1:200; ICC/IF 1:50-1:200; uygulamalarında belirtilen oranlarda seyreltilerek kullanılabilir.
- Ürün konsantrasyonu 2 mg/ml olmalıdır.
- Teklif edilen antikorun saklama buffer'ı PBS, pH 7.4, with 50% glycerol, 0.2% BSA (0.05% sodium azide içeren) olmalıdır.
- Teklif edilen antikor için numune denemesi yapılmış olmalıdır ve uygunluk yazısı alınmış olmalıdır. Uygunluk yazıları ilk defa kullanılacak ürünler için teklif ile beraber sunulmalıdır. Uygunluk yazısı verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Yüklenici firma gerektiğinde, çalışmayan antikor için teknik destek sağlayıp çalışmayı yapabilmelidir.
- Yüklenici firma ihalede yetki belgesini sunmalıdır. Yüklenici firmalar elden teslim etmelidir.

Bax Monoclonal Antibody

- Teklif edilen antikor WB, IHC (P), ICC/IF, Flow, teknikleri için kullanıma uygun olmalıdır.
- Ürün 100 µL ambalajında olmalıdır.
- Teklif edilen antikor Mouse / IgG1 olmalıdır.
- Teklif edilen antikor Human, Mouse, Rat türlerinde reaktivite göstermelidir.
- Teklif edilen antikor performance grade olmalıdır. Antikor çalışmadığı takdirde 15 gün içerisinde ücretsiz değişimi yapılmalıdır.
- Teklif edilen antikor; WB 1:10-1:100; IHC (P) 1:50-1:200; ICC/IF 1:10-1:100; Flow 0.5 µg/test uygulamalarında belirtilen oranlarda seyreltilerek kullanılabilir.
- Ürün konsantrasyonu 0,2 mg/ml olmalıdır.
- Teklif edilen antikorun saklama buffer'ı PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA (0.09% sodium azide içeren) olmalıdır.
- Teklif edilen antikor için numune denemesi yapılmış olmalıdır ve uygunluk yazısı alınmış olmalıdır. Uygunluk yazıları ilk defa kullanılacak ürünler için teklif ile beraber sunulmalıdır. Uygunluk yazısı verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Yüklenici firma gerektiğinde, çalışmayan antikor için teknik destek sağlayıp çalışmayı yapabilmelidir.
- Yüklenici firma ihalede yetki belgesini sunmalıdır. Yüklenici firmalar elden teslim etmelidir.

Bcl-2 Polyclonal Antibody

- Teklif edilen antikor WB, IHC (P), ICC/IF, Flow, teknikleri için kullanıma uygun olmalıdır.
- Ürün 100 µL ambalajında olmalıdır.
- Teklif edilen antikor Rabbit / IgG olmalıdır.
- Teklif edilen antikor Human, Mouse, Rat türlerinde reaktivite göstermelidir.
- Teklif edilen antikor performance grade olmalıdır. Antikor çalışmadığı takdirde 15 gün içerisinde ücretsiz değişimi yapılmalıdır.

- Teklif edilen antikor; WB 1:500-1:3,000; IHC (P) 1:100-1:1,000; ICC/IF 1:100-1:1,000 uygulamalarında belirtilen oranlarda seyreltilerek kullanılabilir.
- Ürün konsantrasyonu 0,2 mg/ml olmalıdır.
- Teklif edilen antikorun saklama buffer'ı PBS, pH 7, with 1% BSA, 20% glycerol (0.025% ProClin 300 içeren) olmalıdır.
- Teklif edilen antikor için numune denemesi yapılmış olmalıdır ve uygunluk yazısı alınmış olmalıdır. Uygunluk yazıları ilk defa kullanılacak ürünler için teklif ile beraber sunulmalıdır. Uygunluk yazısı verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Yüklenici firma gerektiğinde, çalışmayan antikor için teknik destek sağlayıp çalışmayı yapabilmelidir.
- Yüklenici firma ihalede yetki belgesini sunmalıdır. Yüklenici firmalar elden teslim etmelidir.

PLP1 Monoclonal Antibody

- Teklif edilen antikor WB, IHC (P), ICC/IF, Flow, teknikleri için kullanıma uygun olmalıdır.
- Ürün 100 µL ambalajında olmalıdır.
- Teklif edilen antikor Mouse / IgG2a olmalıdır.
- Teklif edilen antikor Human, Mouse, Rat türlerinde reaktivite göstermelidir.
- Teklif edilen antikor performance grade olmalıdır. Antikor çalışmadığı takdirde 15 gün içerisinde ücretsiz değişimi yapılmalıdır.
- Teklif edilen antikor; ICC/IF 1:100 uygulamalarında belirtilen oranlarda seyreltilerek kullanılabilir.
- Ürün konsantrasyonu 1 mg/ml olmalıdır.
- Teklif edilen antikorun saklama buffer'ı PBS, pH 7, with 1% BSA, 20% glycerol olmalıdır.
- Teklif edilen antikor için numune denemesi yapılmış olmalıdır ve uygunluk yazısı alınmış olmalıdır. Uygunluk yazıları ilk defa kullanılacak ürünler için teklif ile beraber sunulmalıdır. Uygunluk yazısı verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Yüklenici firma gerektiğinde, çalışmayan antikor için teknik destek sağlayıp çalışmayı yapabilmelidir.
- Yüklenici firma ihalede yetki belgesini sunmalıdır. Yüklenici firmalar elden teslim etmelidir.

Mouse and Rabbit Specific HRP/AEC (ABC) Detection IHC Kit

- Kit IHC-P' de kullanıma uygun olmalıdır.
- Ürün 15 ml orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- Kit içeriği; AEC Single Solution, Biotinylated Goat Anti-Polyvalent, Protein block ve Streptavidin Peroxidase olmalıdır.
- Ürün +4°C'de saklanabilmelidir.
- Teklif edilen ürün için numune denemesi yapılmış olmalıdır ve uygunluk yazısı alınmış olmalıdır. Uygunluk yazıları ilk defa kullanılacak ürünler için teklif ile beraber sunulmalıdır. Uygunluk yazısı verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Yüklenici firma gerektiğinde, çalışmayan kit için teknik destek sağlayıp çalışmayı yapabilmelidir.
- Yüklenici firma ihalede yetki belgesini sunmalıdır.

- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir. Elden teslim edilmelidir.

Aqueous Mount

- Teklif edilen ürün ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P yöntemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- Fast-Red veya AEC gibi alkolde çözünür kromojenler ile boyanmış bölümleri doldurmak için formüle edilmiş olmalıdır.
- Ürün low-viscosity olmalıdır.
- Uygun damlalıklı şişelerde olmalıdır.
- Lameller suya batırılarak çıkarılabilir olmalıdır.
- Kullanmadan önce ısıtma gerektirmemelidir.
- AMT'den daha serbest akmalıdır.
- Ürün 30 ml'lik orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
- Ready-to-use olmalıdır.
- Ürünün saklama tamponunda koruyucu olarak 0.1% Sodium azide olmalıdır.
- Teklif edilen ürün için numune denemesi yapılmış olmalıdır ve uygunluk yazısı alınmış olmalıdır. Uygunluk yazıları ilk defa kullanılacak ürünler için teklif ile beraber sunulmalıdır. Uygunluk yazısı verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Yüklenici firma gerektiğinde, çalışmayan kit için teknik destek sağlayıp çalışmayı yapabilmelidir.
- Yüklenici firma ihalede yetki belgesini sunmalıdır.
- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir. Elden teslim edilmelidir.

PHOSPHATE BUFFERED SALINE TABLET

- PBS, immünoanalizler için, numune seyreltme için, protein saflaştırması için ve hücre kültürlerinde yıkama tamponu olarak kullanıma uygun olmalıdır.
- Ürün 10X. pH 7.4, 4L olmalıdır.
- Tablet ağırlığı 1g +/- 2% olmalıdır.
- Osmolaritesi ve iyon konsantrasyonu izotonik özellikte olmalıdır.
- Hücre kültürü için toksik özellikte olmamalıdır.
- Orjinal ambalajında 100 adet tablet bulunmalıdır.
- Teklif edilen ürün için numune denemesi yapılmış olmalıdır ve uygunluk yazısı alınmış olmalıdır. Uygunluk yazıları ilk defa kullanılacak ürünler için teklif ile beraber sunulmalıdır. Uygunluk yazısı verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Yüklenici firma gerektiğinde, çalışmayan kit için teknik destek sağlayıp çalışmayı yapabilmelidir.
- Yüklenici firma ihalede yetki belgesini sunmalıdır.
- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir. Elden teslim edilmelidir.

Citrate Buffer

- Teklif edilen ürün IHC-P çalışmasında kullanıma uygun olmalıdır.
- Ürün 10x ve pH 6.0 olmalıdır.
- Ürün 125 ml'lik orijinal ambalajında elden teslim edilmelidir.
- Deiyonize veya distile su ile 1:10 oranında seyreltilmiş olmalıdır.

- Teklif edilen ürün için numune denemesi yapılmış olmalıdır ve uygunluk yazısı alınmış olmalıdır. Uygunluk yazıları ilk defa kullanılacak ürünler için teklif ile beraber sunulmalıdır. Uygunluk yazısı verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Yüklenici firma gerektiğinde, çalışmayan kit için teknik destek sağlayıp çalışmayı yapabilmelidir.
- Yüklenici firma ihalede yetki belgesini sunmalıdır.
- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir. Elden teslim edilmelidir.

Lam Polysinli Teknik Şartnamesi

- Pozitif elektrikle yüklü olmalıdır.
- Formalinle fikse doku kesitleriyle cam kısım arasında kovalent bağlar oluşturacak ve doku kaybını engelleyecek nitelikte olmalıdır.
- İn situ hibridizasyon çalışmalarında da kullanılabilir.
- Teslim sırasında 72 adet lam içeren kutularda orjinal ambalajında açılmamış olmalıdır.
- Teklif edilen ürün laboratuvarımızdaki lam boyama ve lam kapama cihazları ile sorunsuz çalışmalıdır. Uyumluluğu test edilip onay verilecektir.
- Ebatları 26x76 mm ve kalınlığı 1 - 1,03 mm olmalıdır.
- Teklif edilen ürün için numune denemesi yapılmış olmalıdır ve uygunluk yazısı alınmış olmalıdır. Uygunluk yazıları ilk defa kullanılacak ürünler için teklif ile beraber sunulmalıdır. Uygunluk yazısı verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir. Elden teslim edilmelidir.

25389

TEKNİK ŞARTNAME

Recombinant Anti-Iba1 antibody [EPR16588]

- Teklif edilen antikor Flow Cyt (Intra), IHC-P, WB, ICC/IF teknikleri için uygun olmalıdır.
- Ürün 200 ul ambalajında olmalıdır.
- Teklif edilen antikor Rabbit mAb antikor olmalıdır.
- Teklif edilen antikor Human, Mouse, Rat türlerinde reaktivite göstermelidir.
- Teklif edilen antikor performance grade olmalıdır. Antikor çalışmadığı takdirde 15 gün içerisinde ücretsiz değişimi yapılmalıdır.
- Teklif edilen antikor; IHC-p 1/2000, WB 1/500-1/2000 , FC 1/160 uygulamalarında belirtilen oranlarda seyreltilerek kullanılabilir.
- Teklif edilen antikor sıvı formda olmalıdır.
- Teklif edilen antikor 59% PBS, 40% Glycerol, 0.05% BSA, 0.01% miktarda sodium azide ile desteklenerek -20°C'de muhafaza edilebilir.
- Teklif edilen antikor için numune denemesi yapılmış olmalıdır ve uygunluk yazısı alınmış olmalıdır. Uygunluk yazıları ilk defa kullanılacak ürünler için teklif ile beraber sunulmalıdır. Uygunluk yazısı verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Yüklenici firma gerektiğinde, çalışmayan antikor için teknik destek sağlayıp çalışmayı yapabilmelidir.
- Yüklenici firma ihalede yetki belgesini sunmalıdır.
- Firma teklif ettiği ürünün distribütörü olmalıdır.
- Ürün elden teslim edilmelidir, kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.
- Üründe herhangi bir sorun yaşanması durumunda firma yenisi ile ücretsiz değiştirmelidir.

PIPET, 25 ML

- Ürün tespit edilebilir DNase, RNase, insan DNA'sı içermemelidir
- Ürün pirojenik olmamalıdır, sitotoksik olmamalıdır
- Ürün steril olmalıdır
- Ürün yüksek optik netlikte olmalıdır
- Maksimum doğrulukta olmalıdır.
- Damlamasız pipetleme yapabilmelidir.
- Net, kolay okunabilir sayısal değerlere sahip olmalıdır.
- Renkli bir dikey Schellbach şeridi, hacmin okunmasını önemli ölçüde kolaylaştırmalıdır.
- Negatif derecelendirmelerden artan hacim olmalıdır.
- Uluslararası standartlara göre pipet renk kodu olmalıdır.
- Yüksek dereceli polistirenden maksimum netlik vermelidir

(Handwritten signature)

25389

- Her torbada parti numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır.
- Ürün 100 adet ambalajında verilmelidir
- Teklif edilen ürün için numune denemesi yapılmış olmalıdır ve uygunluk yazısı alınmış olmalıdır. Uygunluk yazıları ilk defa kullanılacak ürünler için teklif ile beraber sunulmalıdır. Uygunluk yazısı verilmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Yüklenici firma gerektiğinde, çalışmayan ürün için teknik destek sağlayıp çalışmayı yapabilmelidir.
- Yüklenici firma ihalede yetki belgesini sunmalıdır. Yüklenici firma ürünleri elden teslim etmelidir.
- Ürün teklif veren firmanın stoklarında her zaman bulunmalı ve istenildiğinde düzenli aralıklarla hemen teslimat yapılabilirdir.

Ürün miadı geçmeye yakın olup kullanılmamış ise firma yeni miadlı ürün ile direkt değiştirebileceğini taahhüt etmelidir.

Alkeş.